


RADIATION COUNTER TUBE, halogen quenched, with end window for the measurement of alpha, beta and gamma radiation  
 TUBE COMPTEUR DE RADIATION, a découpage par halogène, avec fenêtre frontale pour la mesure de radiations alpha, bêta et gamma

GEIGER-MÜLLER-ZÄHLROHR mit Löschung mittels Halogen und mit frontalem Fenster zur Messung von Alpha-, Beta- und Gammastrahlung

Filling : Ne, Ar and halogen quenching agent  
 Remplissage: Ne, Ar et halogène comme gaz de coupure  
 Füllung : Ne, Ar und Halogen als Löschesubstanz

Dimensions in mm  
 Dimensions en mm  
 Abmessungen in mm

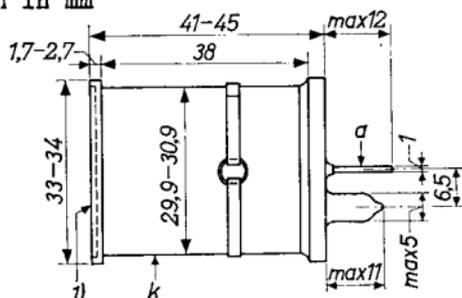

Capacitance, capacité, Kapazität 3,5 pF

Mica window; fenêtre de mica; Glimmerfenster

Effective diameter  
 Diamètre utile 27,8 mm  
 Effektiver Durchmesser

Area  
 Surface 6,1 cm<sup>2</sup>  
 Fläche

Thickness  
 Epaisseur 1,5-2 mg/cm<sup>2</sup>  
 Dicke

<sup>1)</sup> Mica window  
 Fenêtre de mica  
 Glimmerfenster

**18526****PHILIPS**

Cathode Material: 28 % chromium, 72 % iron  
 Katode Nature : 28 % de chrome, 72 % de fer  
 Material: 28 % Chrom, 72 % Eisen

Wall thickness  
 Epaisseur de paroi 1,3 mm  
 Wanddicke

Inside diameter  
 Diamètre intérieur 27,8 mm  
 Innendurchmesser

Effective length  
 Longueur utile 37 mm  
 Effektive Länge

Operating characteristics  
 Caractéristiques d'utilisation  $t_{amb} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$   
 Betriebsdaten

R (fig. 1; Abb. 1) = 10 M $\Omega$   
 $V_{ign}$  = max. 375 V  
 $V_b$  = 1)  
 $V_{pl}$  = 450-750 V  
 $S_{pl}$  = max. 0,02 %/V  
 $N_0$  2) = max. 20 counts /min.  
 = max. 20 impuls./min.  
 = max. 20 Zählgn/Min.  
 $\tau$  ( $V_b = 600 \text{ V}$ ) = max. 200  $\mu\text{sec}$

Limiting values (Absolute limits)  
 Caractéristiques limites (Limites absolues)  
 Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

$V_a$  = max. 750 V  
 $R$  = min. 2 M $\Omega$   
 $t_{amb} = -50 \text{ }^\circ\text{C}/+75 \text{ }^\circ\text{C}$

1) Arbitrary within plateau  
 À volonté dans le plateau  
 Beliebig innerhalb des Plateaus

2) Shielded with 5 cm Pb and 3 mm Al  
 Blindage par 5 cm de Pb et 3 mm d'Al  
 Abschirmung mit 5 cm Pb und 3 cm Al

Mounting: The shortest possible connection between anode and anode resistor and a small capacitance between anode and earth are required

Montage : La connexion la plus petite possible entre l'anode et la résistance anodique et une faible capacité entre l'anode et la terre sont requises

Einbau : Die kürzeste Verbindung zwischen Anode und Anodenwiderstand und eine kleine Kapazität zwischen Anode und Erde sind erforderlich

Recommended circuit; circuit conseillé; empfohlene Schaltung

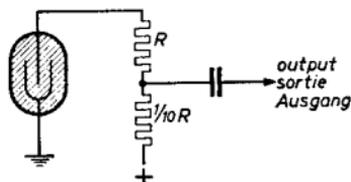
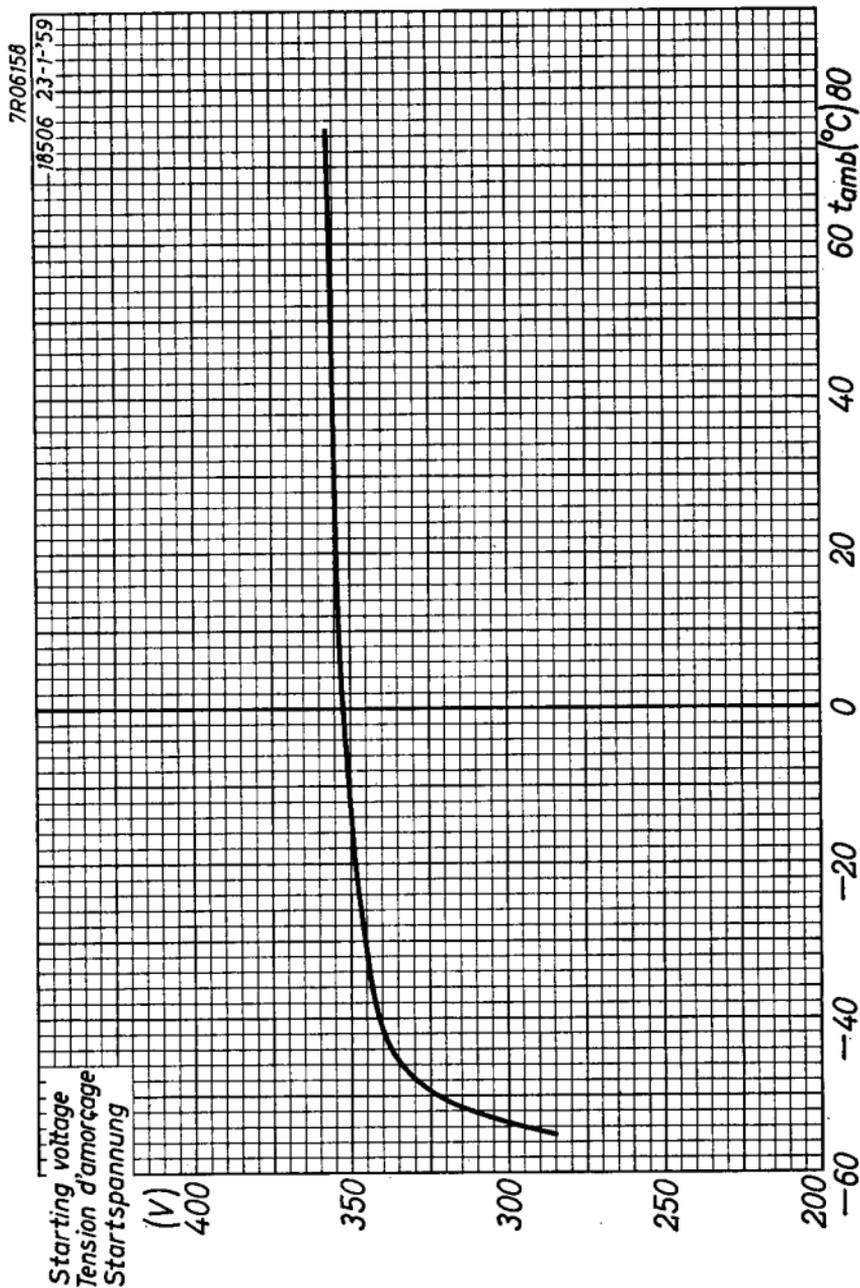


fig.1  
Abb.1


Remark : In order to prevent leakage the tube should be kept dry, and well cleaned

Remarque : Afin d'éviter des courants de fuite il faut tenir les tubes au sec et bien nettoyés

Bemerkung: Zur Vermeidung von Leckströmen sind die Rohre trocken und sauber zu halten

**18526****PHILIPS**

A

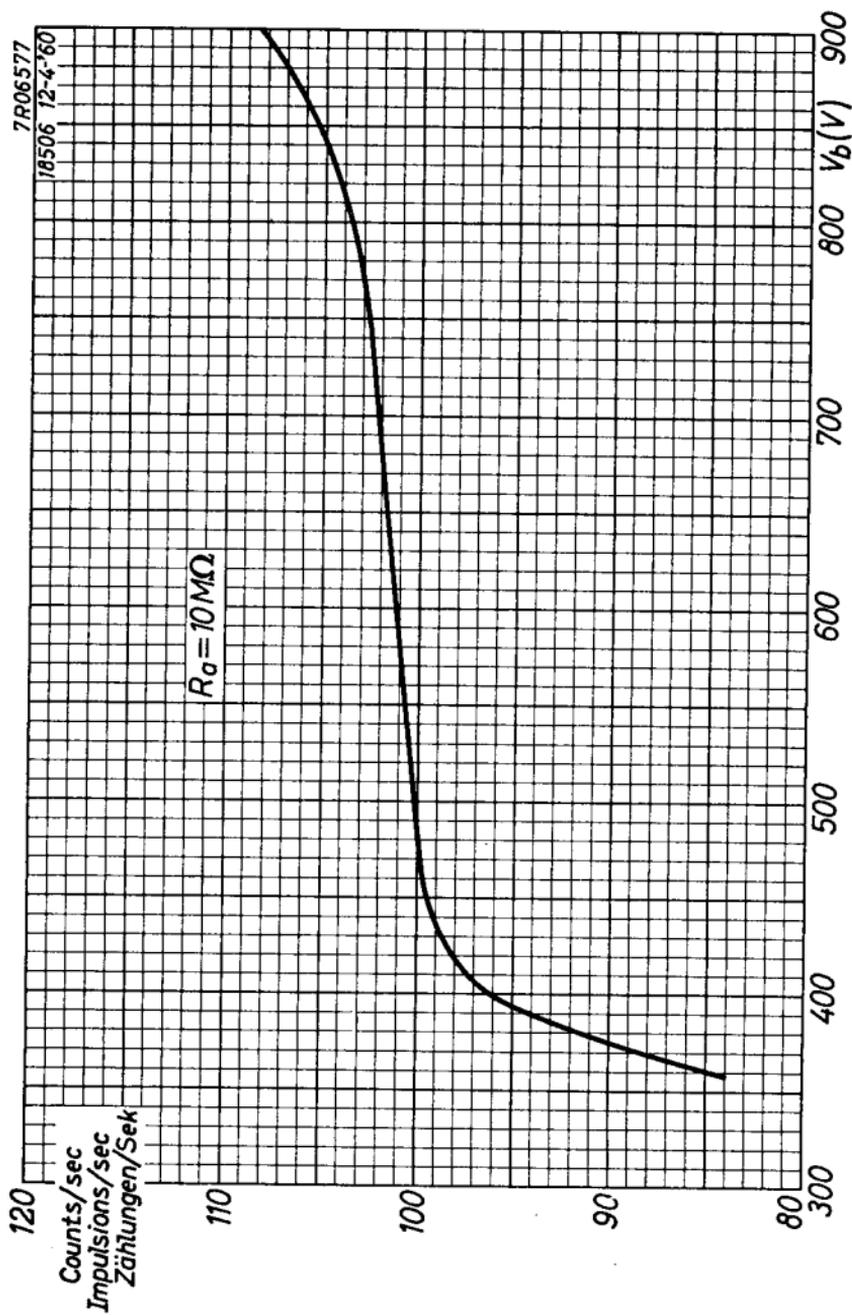


# PHILIPS

## 18526

7Z00498

18526 6-4-67

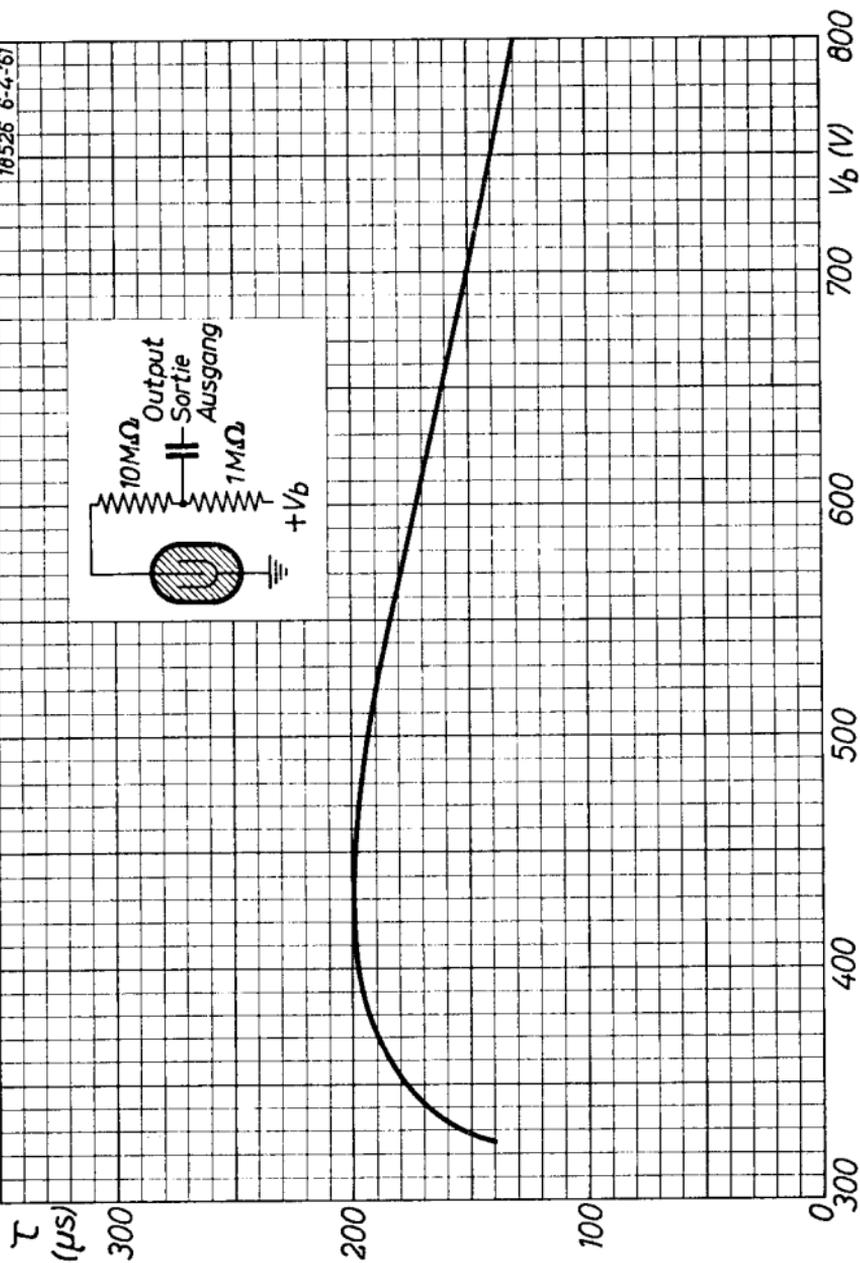

**PHILIPS**



*Electronic  
Tube*

**HANDBOOK**

	<b>18526</b>	
<b>page</b>	<b>sheet</b>	<b>date</b>
1	1	1961.03.03
2	2	1961.03.03
3	3	1961.03.03
4	A	1961.03.03
5	B	1961.03.03
6	C	1961.03.03
7	FP	1999.11.28