



VRIJGAVE FABRICAGE

TYPE D12-130 .. / ...

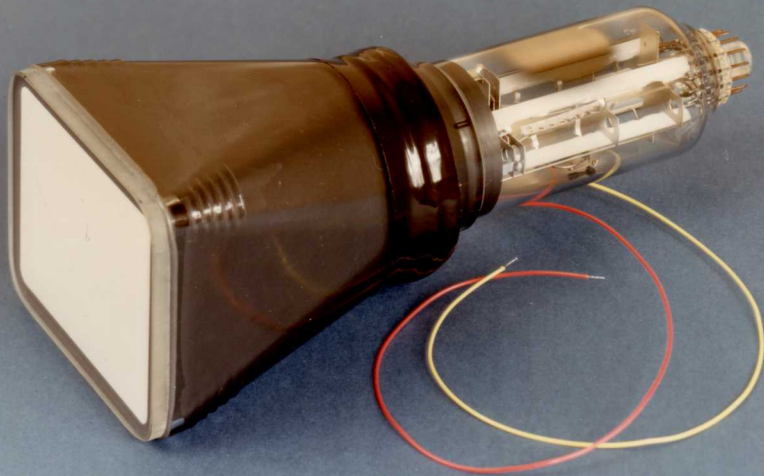

KWALITEITSLAB. PROF. BUIZEN

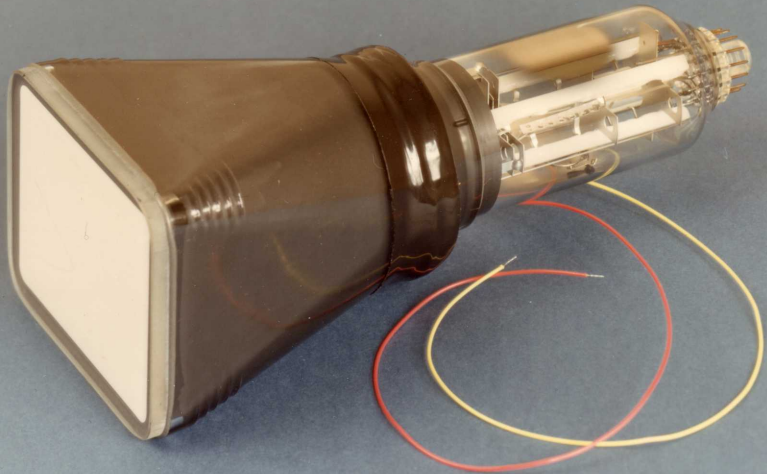



Ontw/Proeffabr.  
overzicht



E L C O M A	KWALITEITS LAB. PHILIPS HEERLEN		
	KHR-89/VL-125	1	1983.08.31

INHOUD RfP DOSSIER D12-130 ../...

<b>ONTVANGEN</b>	
Ontv.	<b>5 SEP. 1983</b>
A. G. SIEBEN	

- Besprekingsverslag KHR-89/VL -126
  - Handtekeningenformulier
  - Foto van de buis
  - Budgetoverzicht
  - Preliminary data (gewijzigd konform bespr. verslag)  
(inclusief gewijzigd interne meetrastertekening)
  - Meeteis d.d. 1983.08.10; bladzijde 362-005 uitwisselen
  - Meetresultaten:
    - \* Vrijgaverapport KHR-89/SB-634
    - \* D12-130 .. meetresultaten KHR-89/VL-123
    - \* Gemiddelde karakteristiekligging KHR-89/SB-633
    - \* Ligtest KHR-89/VL-117
    - \* Levensduur KHR-89/VL-119
    - \* Opbrengstlijst (Hr. Schoder) d.d. 1983.08.22
  - Konkurrentie-onderzoek 12 cm mono d.d. 1983.08.05
  - Overzicht gereedschappen en produktie-apparatuur KHR-20/83-07--47/JS/GA
  - Flow-diagram: met/zonder inwendig meetraster
- Verwijderen { Sam kanon 3322 137 47000 blad 260-001 en 260-002  
en  
Ingedrukt kanon 3322 137 47010 blad 260-002
- Pompen III d.d. 1983.08.23
  - Branden en sweepen d.d. 1983.08.23 RV-5-5-57/1  
Blad 001 uitwisselen d.d. 1983.09.06
  - Speciale materialen KHR-20/83-07-050/HK/GA
  - Ingangskontrolle d.d. 1983.06.29
  - Meetinformatie speciale onderdelen d.d. 1983.07.12
  - Materiaalbalans d.d. 1983.06.20 JBA/hr/024
  - Stempelen en verpakken d.d. 1983.08.09  
(met/zonder raster)
  - Octrooi
  - Kostprijs KHR-12/83-072 AV/OD
  - Garantie situatie